

Cím: Mozgatóberendezés kifejlesztése a térd posztoperatív rehabilitációjára

Időszak: 2006-2007
Program: Öveges József program

Azonosító: HEF_06_3-BIOMDB06
Támogatás: 4 MFt



Eredmények:

Megépítettük az eszköz prototípusát és elvégeztük az első klinikai vizsgálatot is, amelynek feldolgozása

A sarokrezgető működési elve azon alapul, hogy fekvő testhelyzetben a kizárólag a sarok régión kereszt

Az eszköz egy palmtop és egy amplitúdó beállító kar segítségével vezérelhető. A kezelés előtt az amplit

Az eszközzel végzett klinikai vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy használatával a flexiós kontraktúr

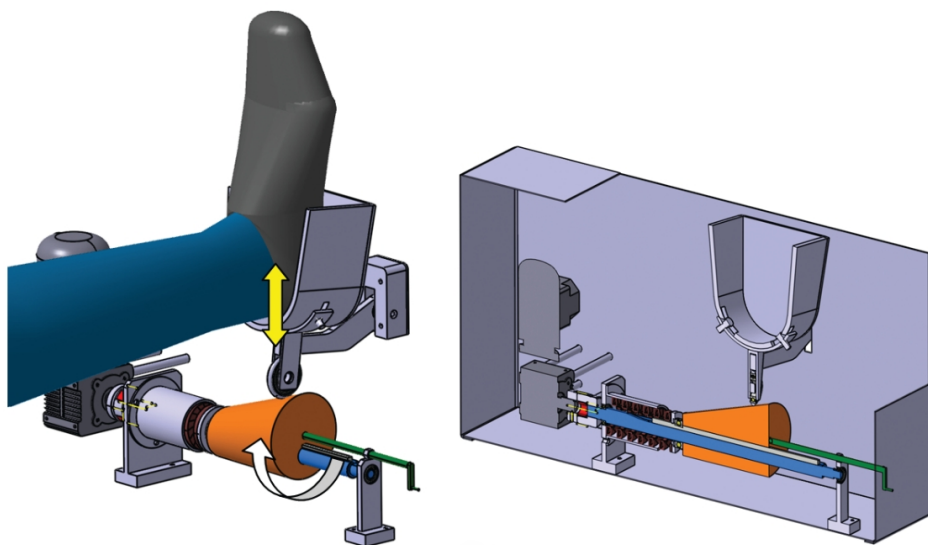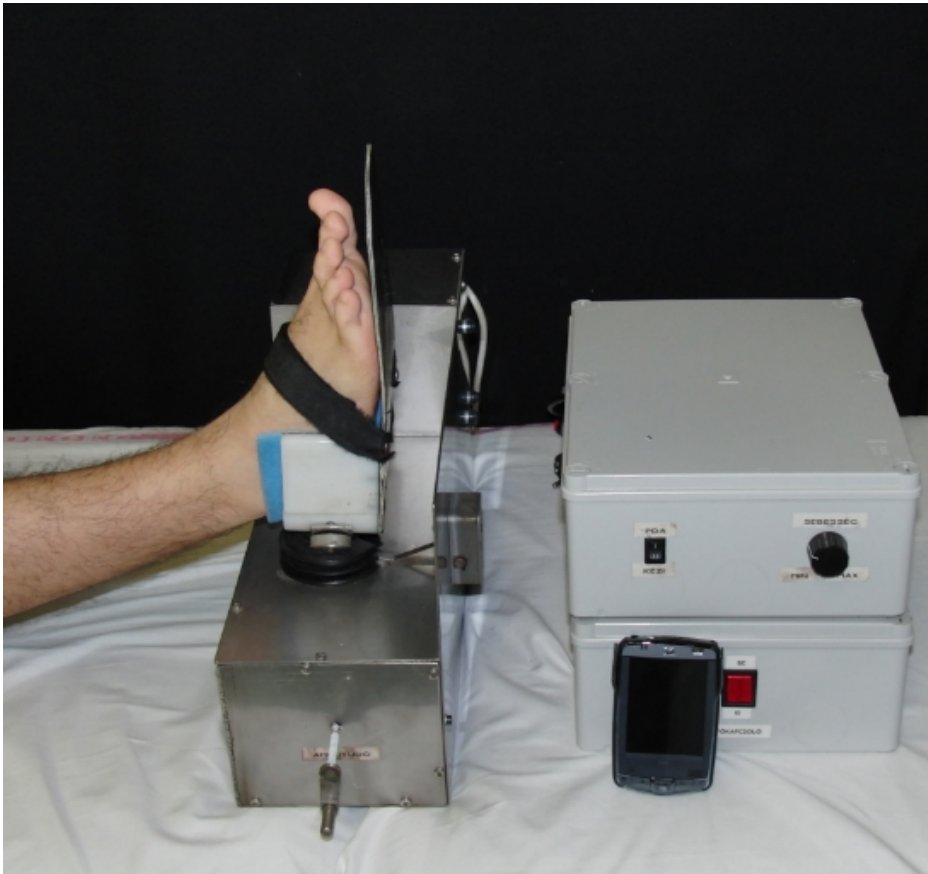

Sample text: The vibration device is designed for... The vibration device is designed for... The vibration device is designed for... The vibration device is designed for... The vibration device is designed for...