



Ebben a komplex, egymásra épülő lépésekből álló projektben a gerincimplantátumok stabilitását vizsgáljuk a műtét során jelen lévő humán anyagok kenési jellemzőinek, valamint a rögzítőcsavar meghúzásának függvényében.

Első lépésként meghatároztuk a műtét során jelen lévő anyagok relatív kenőképességét ismert kenőanyagokhoz viszonyítva. Mivel a kenőképesség mérések elvégzésére szolgáló hagyományos eszközök igen drágák és a mérés is elég bonyolult, úgy határoztunk, hogy létrehozzuk a saját, relatív kenőképesség mérésére szolgáló szerkezetünket, amely alkalmas arra, hogy a humán anyagok, azaz a zsír, vér, synoviális folyadék kenőképességét összevessük egyéb kenőanyagokéval.





The Zwick Roell GZM 10-K250 is a universal testing machine used for material testing and lubricity examination.

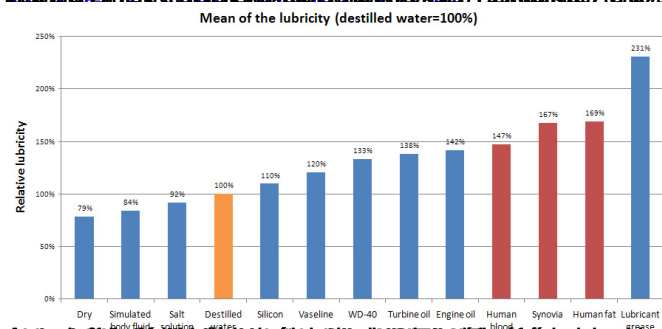

The chart shows the relative lubricity of various materials, with the Lubricant showing the highest value at 231%.

